
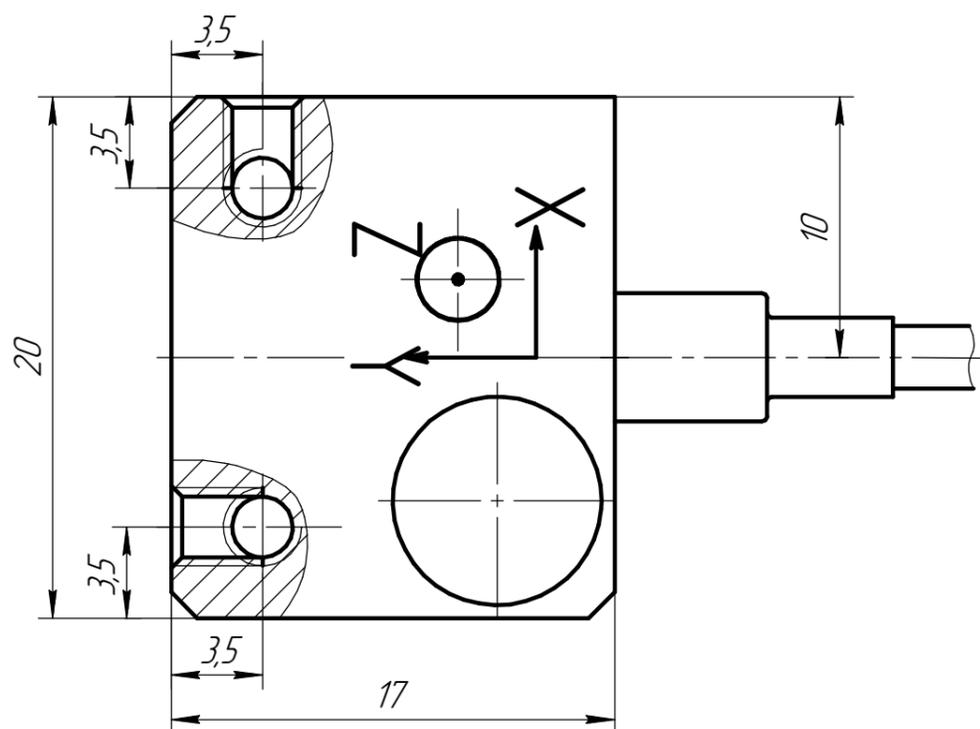


АГТ-192ГЧ

Перв. примен.

Справ. №

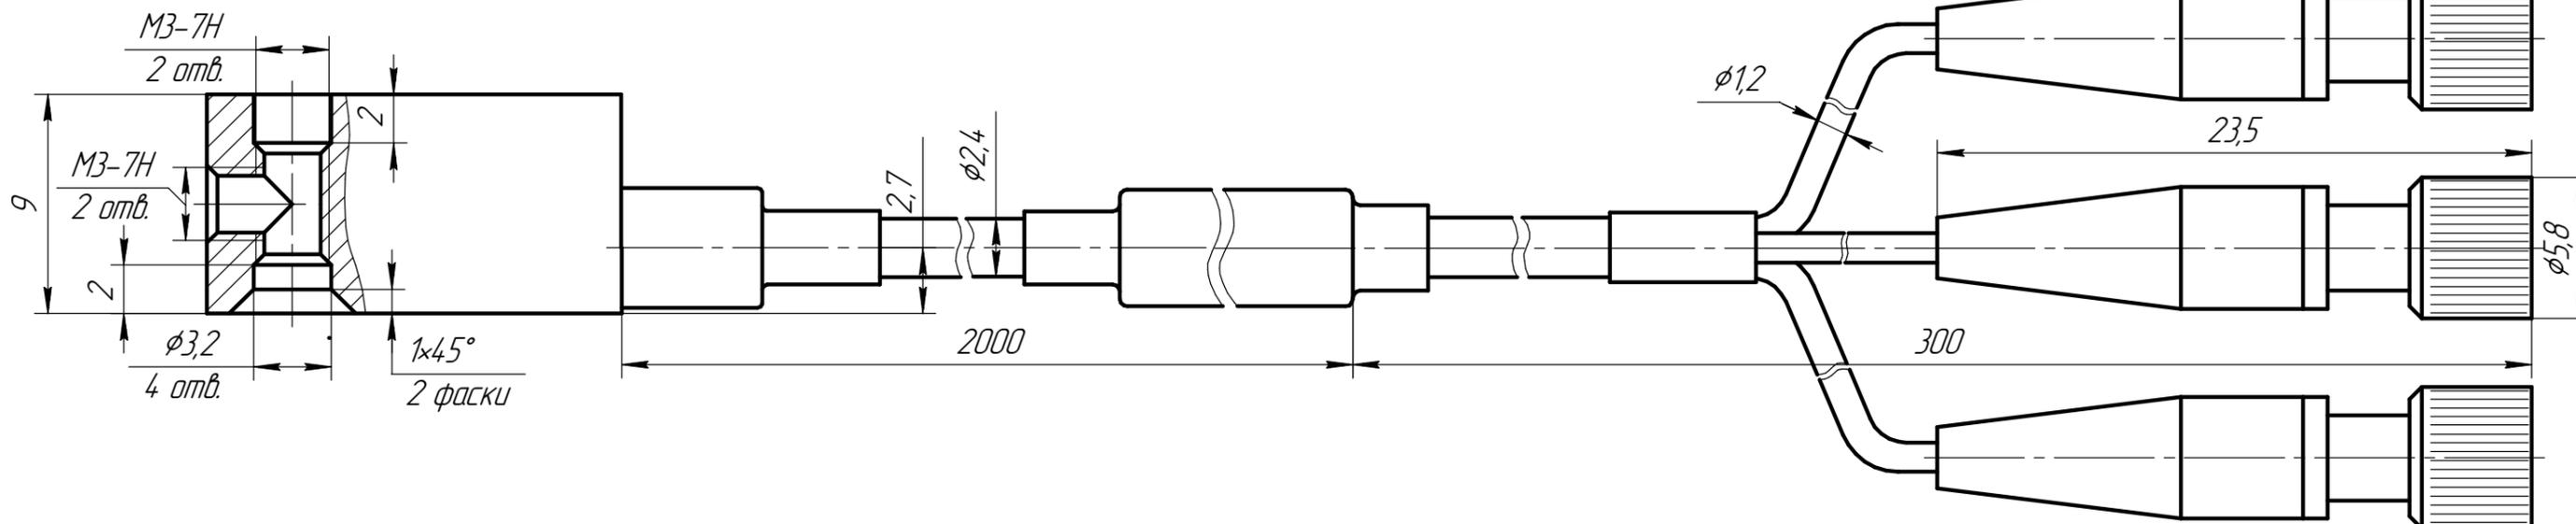

с шероховатостью

1. Размеры для справок.
2. Вибропреобразователь АР1081 крепить моментным ключом с моментом 1..1,5 Н·м, контрить клеем ЭЛ-20 по ОСТ В95 1654-75.
3. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь АР1081, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05,

✓ Rz 20
Ra 1,25

Подп. и дата

Инд. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

				АГТ-192ГЧ				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вибропреобразователь АР1081 Габаритный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Краснощекоев						5:1
Проб.		Шамаев				Лист	Листов	1
Т.контр.					ООО "Глобалтест"			
Н.контр.		Скобеев						
Утв.		Кирпичев						

Копировал

Формат А3