
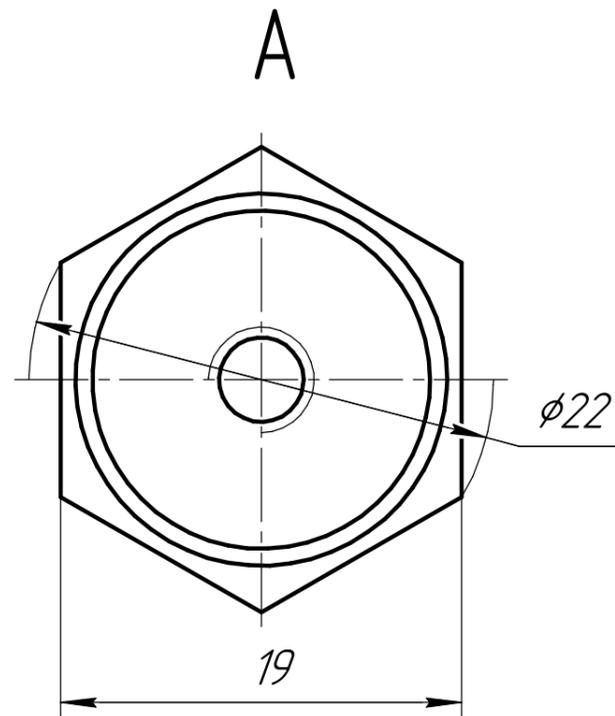


АГТ-191ГЧ

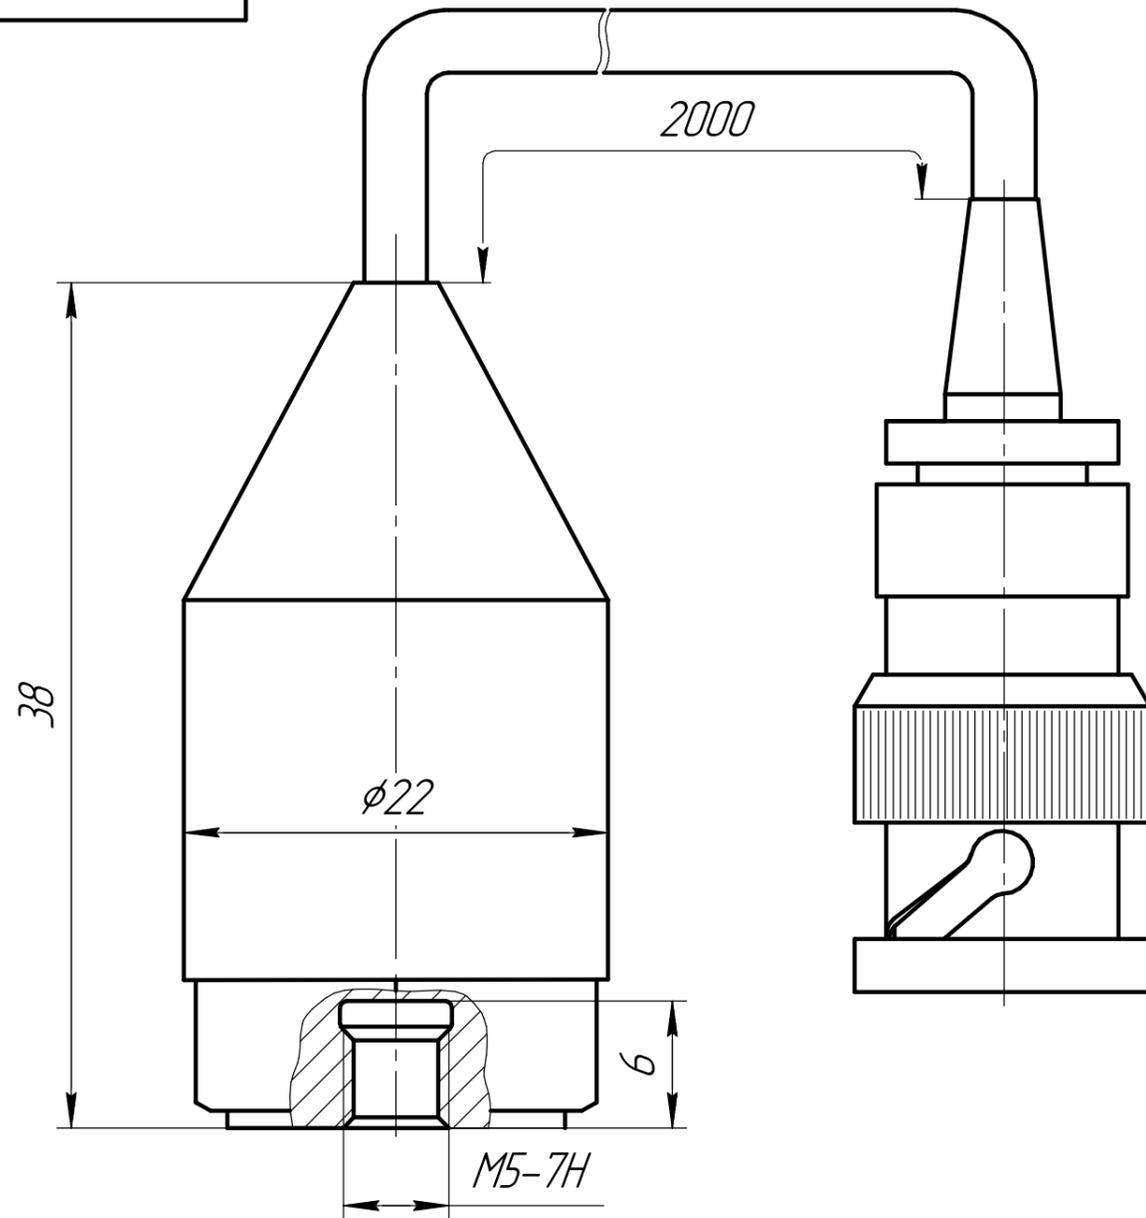

1. Размеры для справок.
2. Вибропреобразователь АР1090 крепить моментным ключом (размер под ключ 19 мм) с моментом 1,9...2,1Нм.  
Допускается контролька клеем ВК-9 и склеивание по ОСТ В95 1653-75.
3. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь АР1090, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05мм, с шероховатостью  $\checkmark$  Rz 20 Ra 1,25

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					АГТ-191ГЧ			
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Вибропреобразователь АР1090 Габаритный чертёж	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Новоселов							2,5:1
Проб.						Лист	Листов	1
Т.контр.								
Н.контр.	Краснощевков				ООО "Глобалтест"			
Утв.	Кирпичев							