

АБКЖ.433642.034ГЧ

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

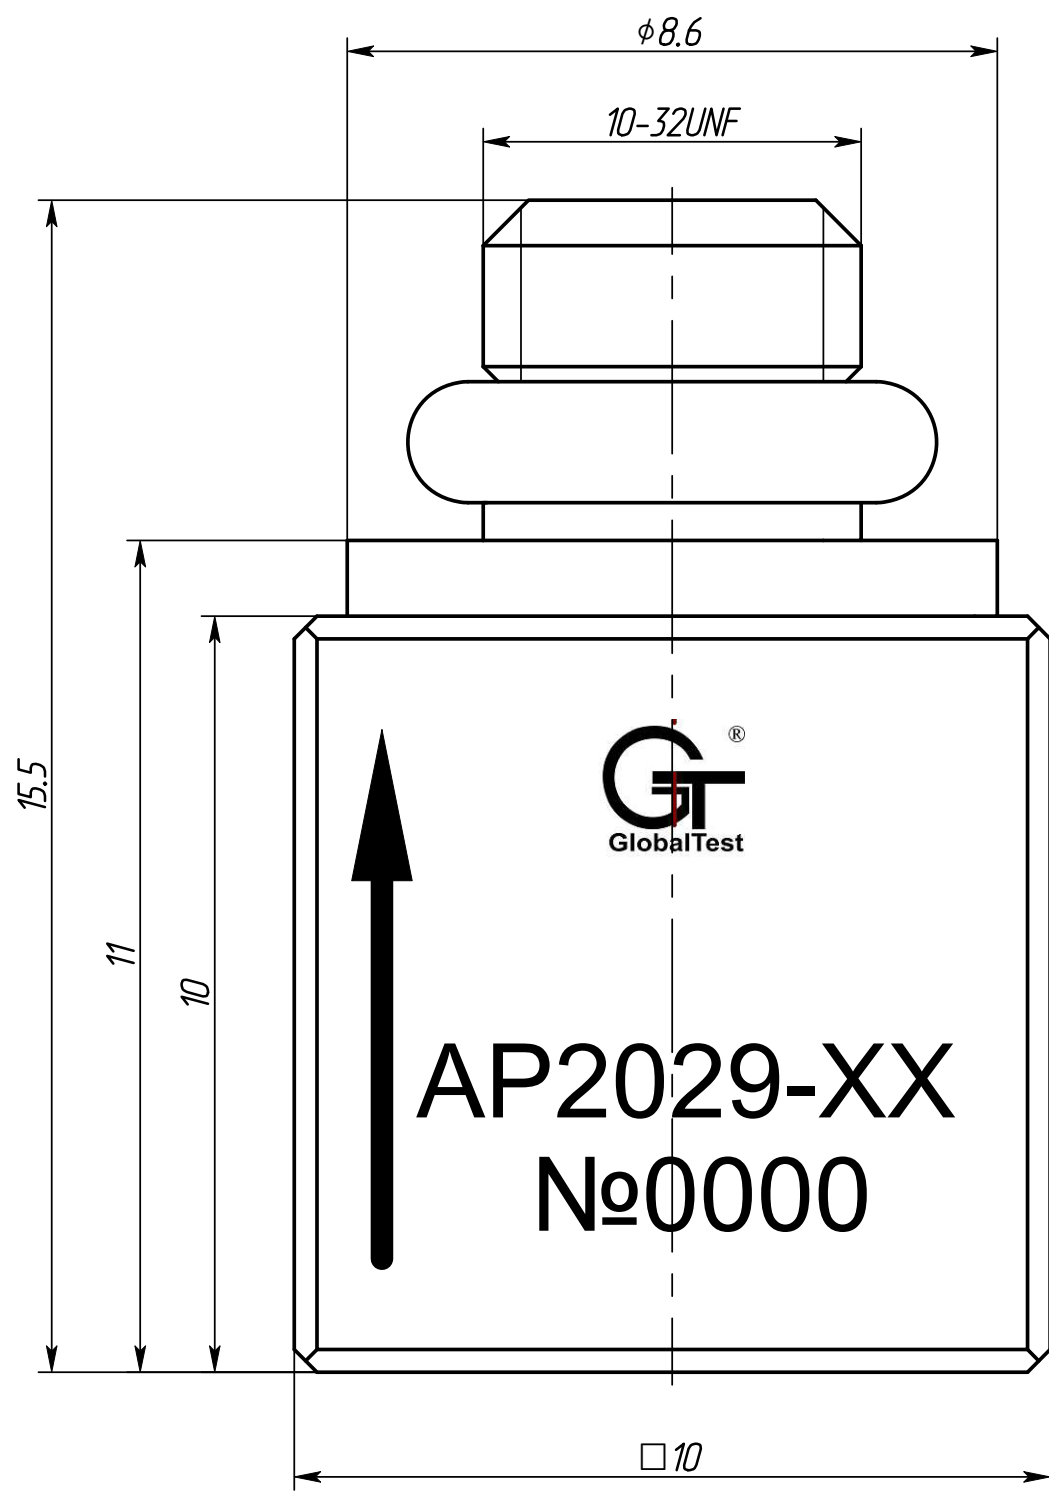

1. Поверхность объекта испытаний, на которую устанавливается вибропреобразователь AP2029, должна быть выполнена с допуском плоскостности 0,05 мм, с шероховатостью не грубее $\sqrt{Ra2.5}$.
2. Остальные ТТ по ОСТ В95 2606-90.

Обозначение	Плата	Примечание
АБКЖ.433642.034	AP2029-100	AP2029-100
-01	AP2029-10	AP2029-10

					АБКЖ.433642.034ГЧ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вибропреобразователь AP2029-XX	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Кутцев						10:1
Пров.		Новоселов				Лист	Листов	1
Т.контр.						ООО "ГлобалТест"		
Н. контр.		Краснощеков						
Утв.								